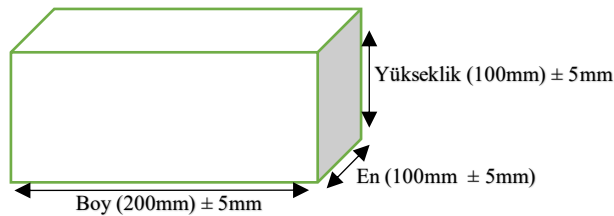
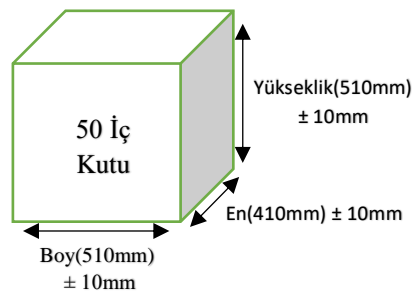


Ek-1:**Tıbbi/Cerrahi Maske (Arkadan Lastikli ya da Arkadan Bağcıklı) Teknik Şartnamesi**

- A) Ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
- B) Maskenin sağ ve sol tarafında kulak arkasından geçirilen lastikli ya da kafa arkasından bağlanabilir bağcıkları olmalıdır Maske 6-8 saat süreyle sürekli kullanıma uygun olmalıdır.
- C) Burun ayarlanabilir yumuşak tel destekli veya telsiz olmalıdır.
- D) Non-woven, polipropilenden yapılmış olmalıdır.
- E) Mavi, yeşil veya beyaz renkte olmalıdır.
- F) Antialerjik ve kokusuz olmalıdır.
- G) Üç katlı olmalıdır.
- H) Sıvı bariyer özelliği bulunmalı, fiber-glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir.
- İ) Nefes alışverişi kolay olmalı, koruyucu gözlükle beraber kullanılabilirdir.
- J) Tıbbi/Cerrahi Maskeler 50'lik kutular halinde olmalıdır.
- K) EU MDD Directive 93/42/EEC Kategori III veya eşdeğeri; EN 14683 Type II, IR, IIR; ya da ASTM F2100 minimum Level 1 veya eşdeğeri standartlara sahip olmalıdır.
- L) Ultrasonic veya Makine Dikişli olmalıdır.
- Tıbbi/Cerrahi Maskenin Telli veya Telsiz oluşu, ultrasonik veya makine dikişli oluşu, iç/dış katman materyalinin gramajı, filtrasyon kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhülle ayrıca belirtilecektir.
- M) Tıbbi/Cerrahi Maskeler telli veya telsiz olma durumuna göre ayrı ayrı iç/dış kutularda ambalajlanacaktır. Aynı iç/dış kutu içerisinde tıbbi/cerrahi maskeler karışık olarak bulunmayacaktır.
- N) Tıbbi/Cerrahi Maskelerin iç ve dış ambalaj kutularının boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır.

İç Kutu Boyutları**Dış Kutu Boyutları**

O) Tıbbı/Cerrahi Maskelerin iç ve dış ambalaj kutularının etiketlemesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

İç ve Dış Ambalaj Kutusu Etiketlemesi

İç ambalaj kutuları üzerine aşağıdaki bilgiler kalıcı ve okunaklı olarak basılmış veya etiketlenmiş olacaktır.

-Firma ticari unvanı ve adresi,

-Malzemenin adı,

-Malzemenin cinsi (telli veya telsiz oluşu)

Her dış koli üzerine yukarıda belirtilen bilgilerin yanı sıra en az aşağıda belirtilen bilgiler kalıcı ve okunaklı olarak 4 yan yüzüne basılmış veya etiketlenmiş olacaktır.

-İçerisindeki iç ambalaj adedi,

-Brüt kütlesi (kg cinsinden)

.../.../.....

TAAHHÜTNAME

Sözleşmeye konu Tıbbi/Cerrahi Maskenin (Telli/Telsiz), dış katman materyalinin gramajının gram/metrekare, filtrasyon kumaşının gramajının gram/metrekare olduğunu taahhüt ederiz.

Onaylayan Firma Yetkilisinin:

Adı-Soyadı :

İmzası :

Firma Kaşesi :